Gerätebeschreibung: DAUER_Kurz_Methan_neu

wie Grafik am Gerät

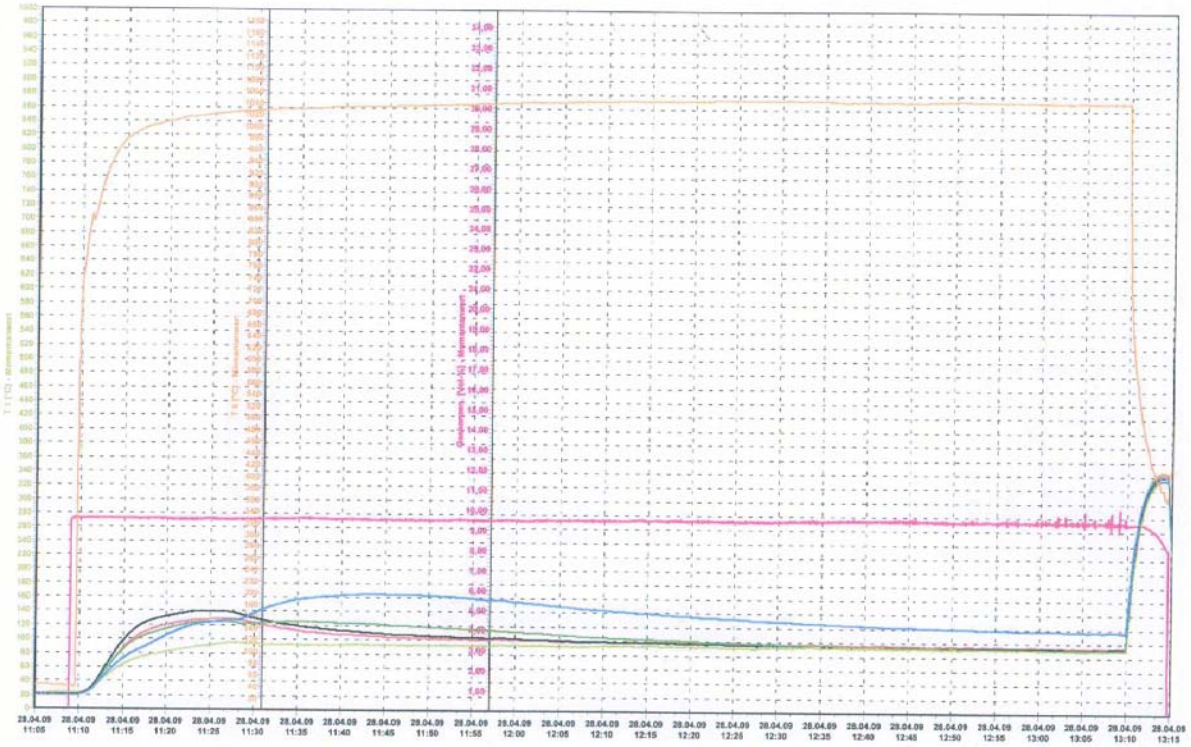

Gaskonzen.	[Vol-%]	Momentanwert	0,00 .. 34,86	T 3	[°C]	Momentanwert	0 .. 1000	T 6	[°C]	Momentanwert	0 .. 1200
T 1	[°C]	Momentanwert	0 .. 1000	T 4	[°C]	Momentanwert	0 .. 1000				
T 2	[°C]	Momentanwert	0 .. 1000	T 5	[°C]	Momentanwert	0 .. 1000				

Kommentar: Dauerbrandvs. SCHAER HITECH SDB 2029 (DN 200 / Ex.-G. I (IIA1) 9,5 V.-% CH4
Vm=0,5*Vc=32,5 m³/h, BD 120 min, KZ, Tmax = 165/345 °C, IB-08-3-031/4, SCHAER HI

Datenintegrität: OK

Datum / Zeit des Ausdrucks: 28.04.09 13:29:05

Druckbereich der Aufzeichnung: 28.04.09 11:05:00 bis 28.04.09 13:15:00